


新発売!

ラット過剰排卵誘起剤

CARD HyperOva for RAT

1.2mL 15,000円 (参考価格)

CARD HyperOva for RATは、PMSG/hCGによる過剰排卵と比較して、より高い効率で排卵を誘発する過剰排卵用試薬です。

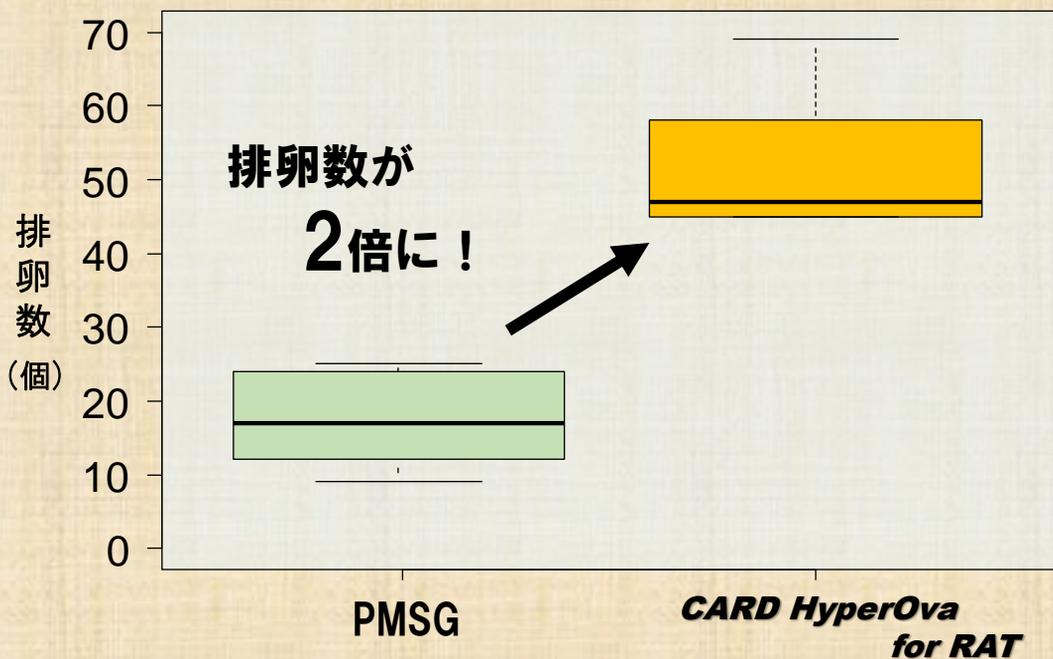

☆動物の使用数削減により3Rに貢献!☆

動物1匹あたりの排卵数が増えると、必要な動物の数が少なくなります。

サンプル品をご用意しております。ぜひこの機会にお試しく下さい。

🐭 サンプル品お申し込み先 🐭

九動株式会社 生殖工学技術部 生殖工学試薬課

E-mail: web_req@kyudo.co.jp FAX: 0942-83-7878



生殖工学関連試薬一覧

Code No.	ラット用生殖工学関連試薬	規格	保存温度
FR001	CARD FERTIUP ラット精子凍結保存液	1.5 mL	-80℃~-20℃
FR002	CARD ラット体外受精用培地	1.0 mL	4℃
FR003	NEW ラット過剰排卵誘起剤 CARD HyperOva for RAT	1.2 mL	-80℃~-20℃

Code No.	マウス用生殖工学関連試薬	規格	保存温度
F003	CARD FERTIUP マウス精子凍結保存液	0.13 mL	18℃~28℃
F004		0.5 mL	
F005		1.0 mL	
F008	CARD FERTIUP マウス精子前培養培地	0.5 mL	4℃
F009		1.0 mL	
F013	CARD MEDIUM 高性能マウス体外受精用培地	1キット	4℃
F014	CARD FERTIUP マウス精子前培養培地 0.5 mL- CARD MEDIUM マウス体外受精用培地 キット	1セット	4℃
F015	CARD FERTIUP マウス精子前培養培地 1.0 mL- CARD MEDIUM マウス体外受精用培地 キット	1セット	
F021	マウス過剰排卵誘起剤 CARD HyperOva	1.0 mL	-80℃~-20℃
F022		0.6 mL	
F024	マウス過剰排卵誘起剤CARD HyperOva F.D. (2.0mL相当凍結乾燥粉末、溶解用滅菌水)	1キット	4℃
F025		5キット	
GA017	CARD mHTF 培地 (マウス体外受精用培地)	2.0 mL	4℃
GA018		5.0 mL	
GA019	CARD KSOM (胚培養用培地)	2.0 mL	4℃
GA020		5.0 mL	
GA021	CARD 0.25 M Sucrose (凍結胚融解用試薬)	2.0 mL	4℃
GA022		5.0 mL	
GA023	CARD 1M DMSO (凍結胚作製用試薬)	1.0 mL	4℃
GA024	CARD DAP213 (凍結胚作製用試薬)	0.5 mL	4℃
GA025		1.0 mL	

Code No.	マウス/ラット生殖工学関連器具	規格	保存温度
GA001	ストロー操作用シリンジ	個	—
GA003	トライアングルカセット 短 145mm 10本入	セット	—
GA004	トライアングルカセット 長 278mm 10本入	セット	—
GA007	卵管操作用マイクロピンセット	本	—
GA008	精子充填用ストロー 10本入	セット	—
GA011	CARD 冷蔵輸送キット (*内容物の精巢上体尾部用冷蔵保存液の保存温度)	キット	4℃*
GA012	胚操作器具セット マウス卵管移植用ガラスキャピラリー20本 他(滅菌済)	セット	—
GA014	マウス精子凍結用フロート	本	—
GAR001	CARD ラット精子凍結用キット	キット	—

表示は税抜金額です。その他、送料別途頂戴いたします。

2024年7月作成

マウス/ラット生殖工学関連試薬は、研究使用のみを対象としており、診断・治療目的には使用できません。

